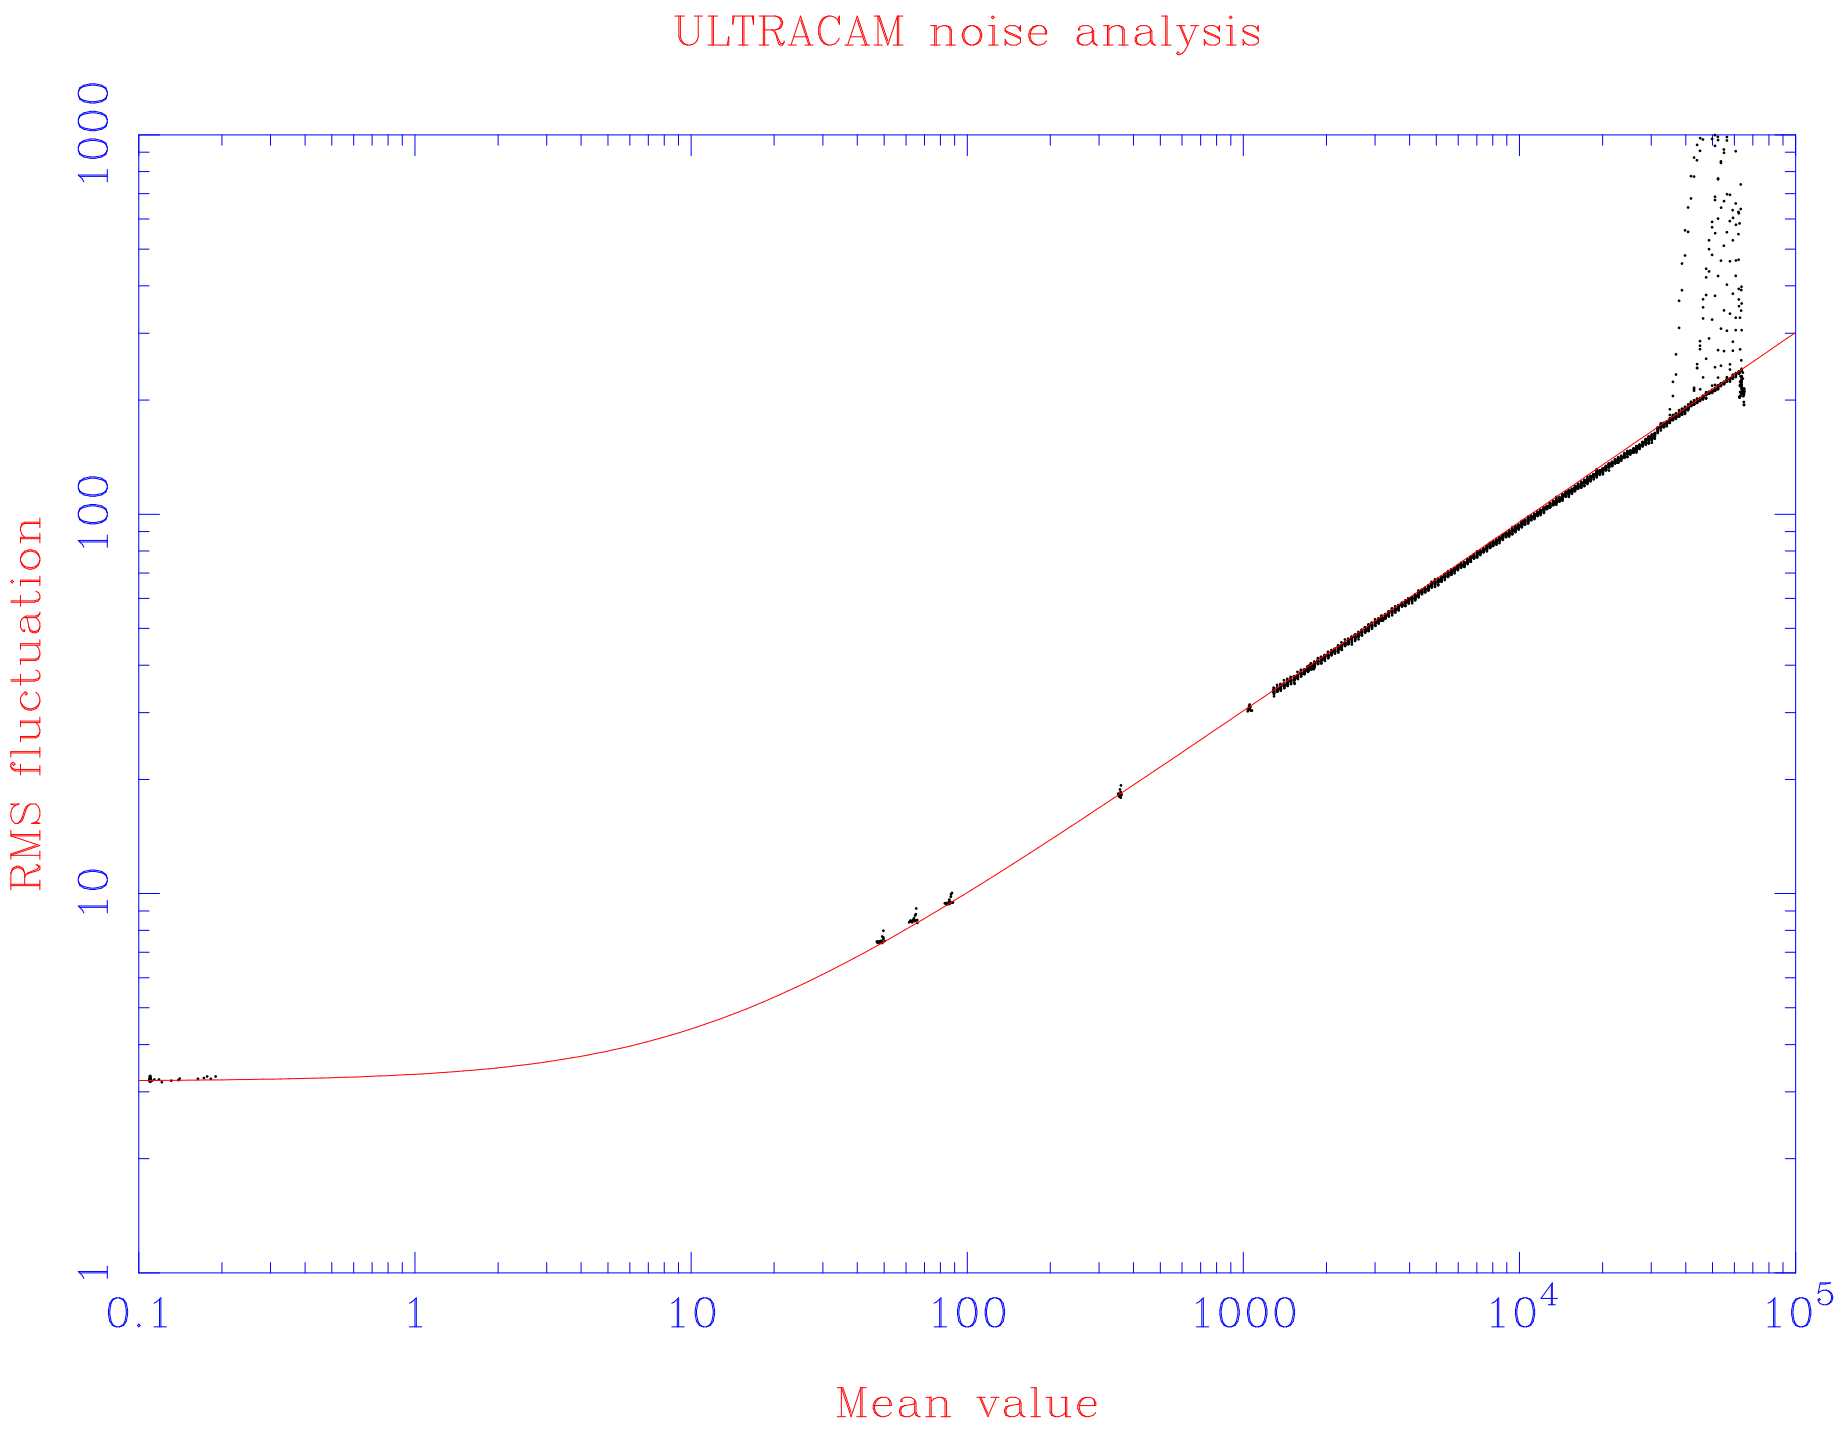
ULTRACAM noise analysis
RMS fluctuation
1000
100
10
1
0.1
1
10
100
1000
10^4
10^5
Mean value