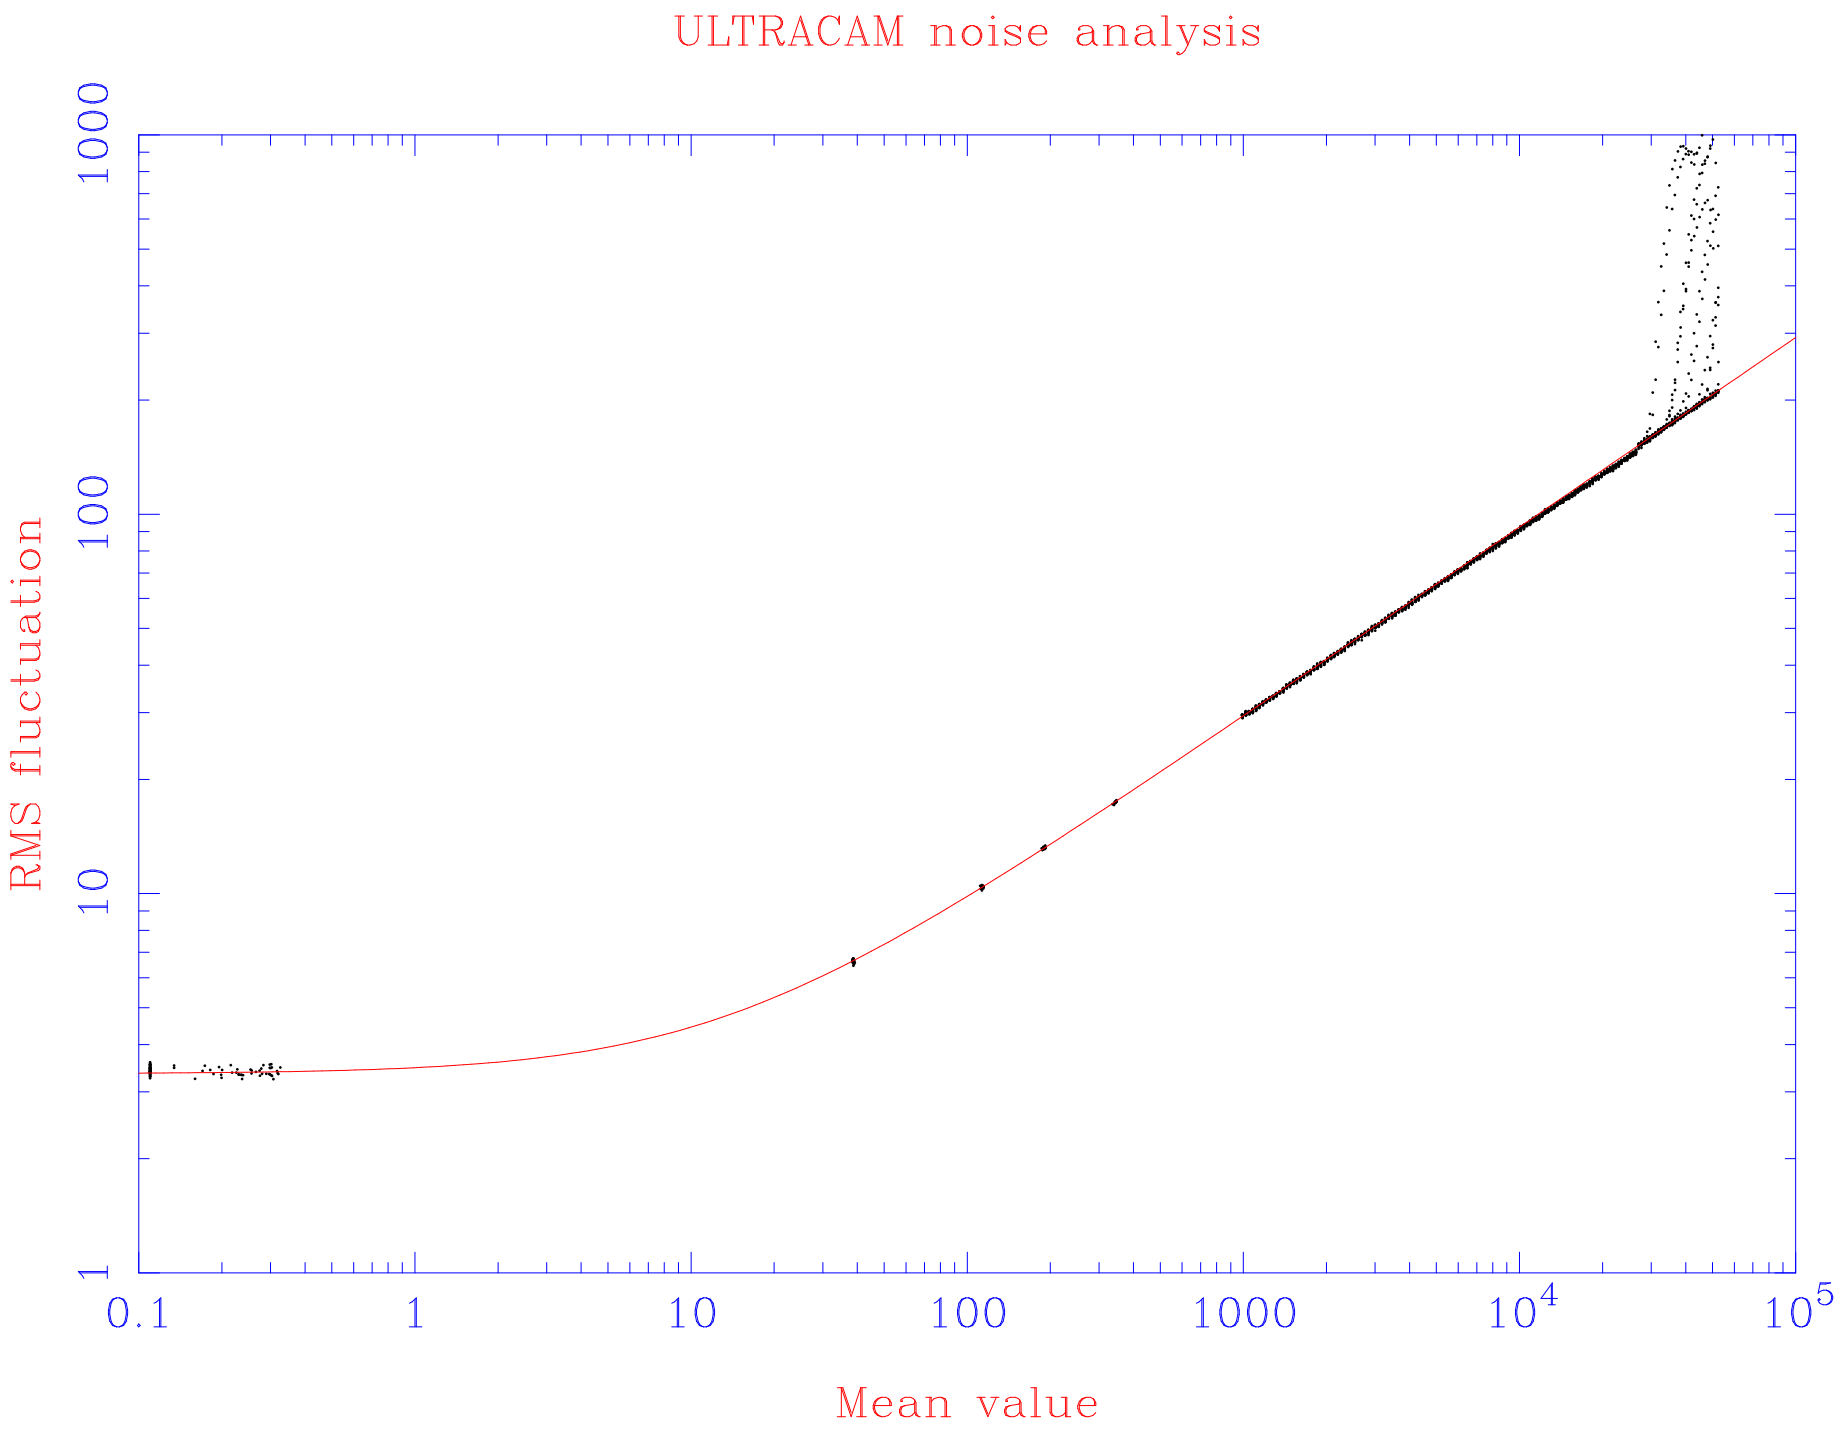
ULTRACAM noise analysis
RMS fluctuation
1000
100
10
1
0.1
1
10
100
1000
$10^4$
$10^5$
Mean value